

CRITERES DE CHOIX D'UN ECHOCARDIOGRAPHE EN REANIMATION

Antoine Vieillard-Baron, Boulogne

QUE FAUT IL EXIGER D'UN APPAREIL D'ECHO EN USI?

- Taille et maniabilité
- Signaux physiologiques (signal de ventilation) => Variations VCS
- Numérisation online clips video
=> archivage numérique, outil pédagogique
- Qualité des fonctions de base
- Fonctions « nouvelles » (pour un réanimateur!): seconde harmonique, DTI...

TAILLE



CV 70 Siemens

Alpha 5 Aloka



HD 11 Philips



Cara Hitachi



Xario Toshiba



Vivid i GE




SIGNAL PHYSIOLOGIQUE





QUALITE DES FONCTIONS DE BASE

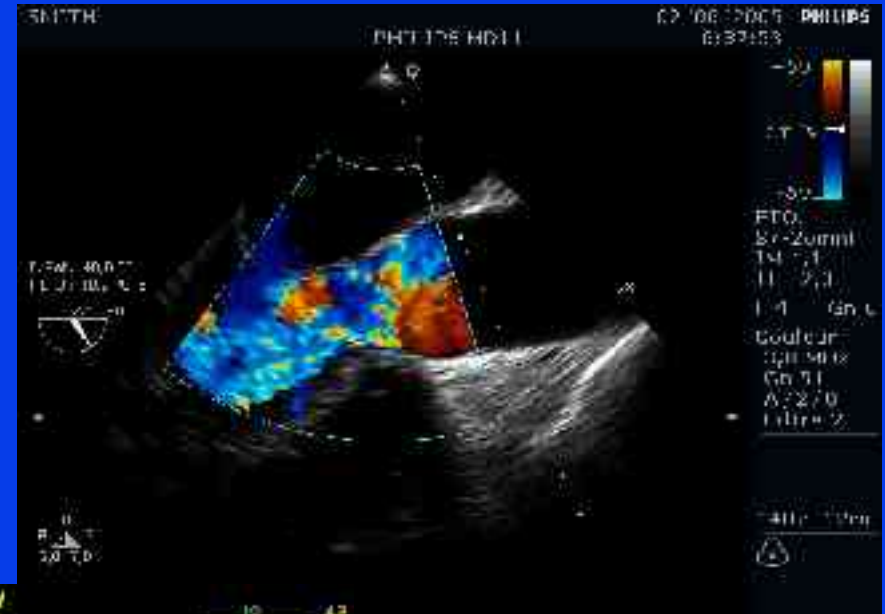

« NOUVELLES » FONCTIONS




CV70 Ver 0.7.100 Sample

75-08:54:52 WA 14055700 ACUSON
CV70

CARDIAC 1

F42 3.4T 2.14

FPS 720

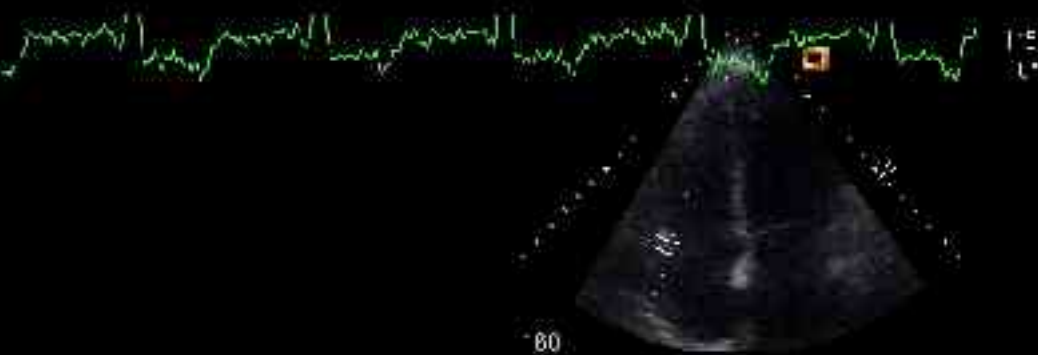

2.5L-H

80

1.2



4.5ec

PC 50.004

D 3590 F 0043

M 0.7

T1706 Tx 170%

